SALINITAT

Ús aparell

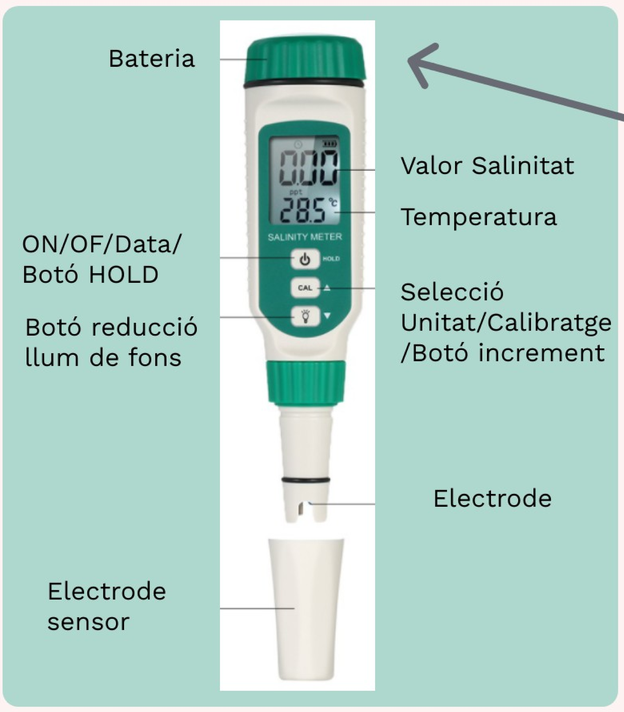

1. Treure la coberta protectora del sensor.

   Prem el botó. A la pantalla apareix el valor de temperatura i valor de salinitat que és 0.

2. **Introdueix l'aparell en el líquid**. Mou un mica l'aparell perquè s'escapi l'aire de l'electrode i així assegurem mesura precisa.

3. L'electrode ha d'està **completament submergit** en el líquid a mesurar.

4. Per retenir a la pantalla el valor cal pressionar HOLD. Per sortir d'aquesta funció pressiona un altre cop HOLD.

Després medició

5. **Esbandir l'electrode** amb aigua desionitzado o destil·lada i guardar sec.

6. **Col·locar la coberta** protectora sobre l'electrode per guardar

7. Si hem acabat mesures i ha d'estar molt temps sense ser usat, treure les bateries.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Recursos de Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels